




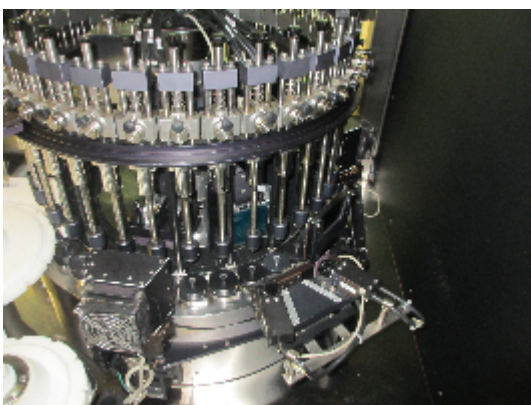

Kontrollgeräte für Ampullen und Vials Brevetti Cea A50/300

Fotos

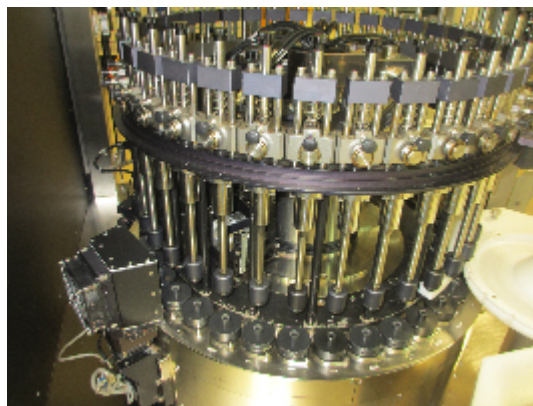

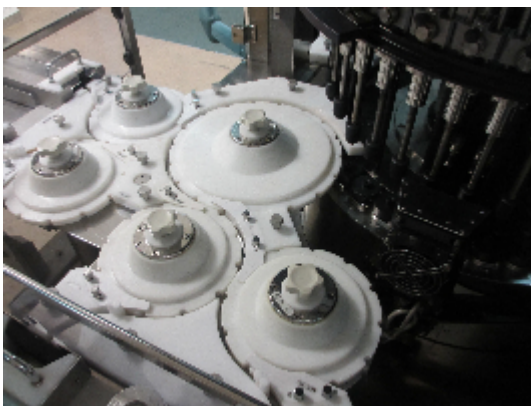

Angaben zum Produkt

Kategorie:	Kontrollgeräte für Ampullen und Vials
Maschine:	A50/300
Maschinencode:	24-1229
Maschinenhersteller:	Brevetti Cea
Baujahr:	2009

Beschreibung

Inspektionsmaschine der Marke Brevetti CEA Modell A50/300 BJ2009 mit Ersatzteilen.
Die Maschinendaten sind wie folgt:

Formate: 1&2ml 10,75Ø Maximale Geschwindigkeit 18000 Ampullen in 1h.
5ml 14,75 Ø Maximale Geschwindigkeit 18000 Ampullen in 1h.

Kontrollstationen: St. 0 Blasköpfe/Kosmetik
St. 1 Partikel
St. 2 Partikel und Füllhöhe
St. 3 Schwarzbrenner
St. 4 Partikel

Auslaufkanäle: 2 Gutausläufe
2 Schlechtausläufe

Dokumentation: Bedienungsanleitung
Ersatzteilkatalog

Gewicht: 2050 kg